


Vue éclatée du dosimètre radio photo luminescent de l'IRSN

Partie antérieure du conditionnement



Partie postérieure du conditionnement

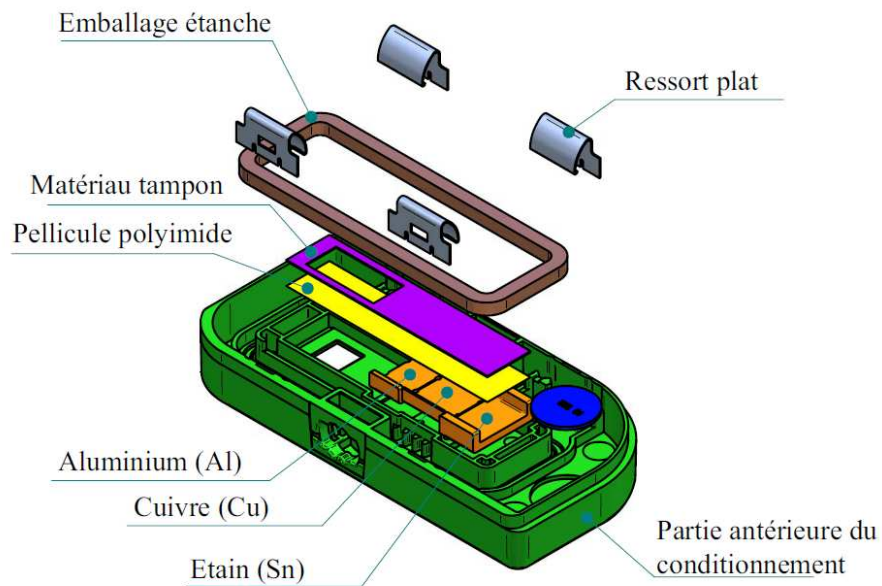